



压力容器合格证

制造单位	上海朗银压力容器有限公司		
制造单位 统一社会信用代码	913101147737269702	制造许可证编号	TS2231119-2023
产品名称	立式蒸汽灭菌器 (65)	制造许可级别	中、低压容器(D)
产品编号	21LY03376	设备代码	217031119202103376
产品图号	SHSDK20-004-00	压力容器类别	I
设计单位	无锡顺华工程设计有限公司		
设计单位 统一社会信用代码	913202063137538558	设计许可证编号	TS1210810-2023
设计日期	2020年7月	制造完成日期	2021年7月2日

本产品在生产过程中经过质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及其设计图样、相应技术标准和订货合同的要求。

检验责任工程师 (签章) 

日期: 2021年7月2日

质量保证工程师 (签章): 

日期: 2021年7月2日

产品质量检验专用章: 

日期: 2021年7月2日

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2231119-2023

单位名称: 上海朗银压力容器有限公司

住所: 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2958号1幢


制造地址: 1. 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2958号1幢

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力容器制造	中、低压容器(D)	-	/

发证机关: 上海市市场监督管理局

有效期至: 2023年11月16日




发证日期: 2019年10月22日

压力容器产品数据表

产品名称	立式蒸汽灭菌器 (65)			设备品种	E					
产品标准	GB150-2011, TSG21-2016			产品编号	21LY03376					
设备代码	217031119202103376			设计使用年限	10 年					
主要参数	容器容积		0.065m ³	容器内径		450 mm	容器高/长		790.5 mm	
	材料	筒体 (球壳)	S30408	厚度	筒体 (球壳)	3 mm	容器自重		46 kg	
		封头	S30408		封头	3 mm				
		衬里	/		衬里	/ mm	盛装介质重量		~111 kg	
		夹套	/		夹套	/ mm				
	设计压力	壳程	-0.1/0.28 MPa	设计温度	壳程	141 °C	最高允许工作压力	壳程	/ MPa	
		管程	/ MPa		管程	/ °C		管程	/ MPa	
		夹套	/ MPa		夹套	/ °C		夹套	/	
	壳程介质		水, 水蒸汽		管程介质		/		夹套介质	/
	结构形式	主体结构型式		单层		安装型式		立式		
支座型式		支撑		保温绝热方式		/				
检验试验	无损检测方法		RT-III		无损检测比例		AB 类 RT: 20%			
	耐压试验种类		水压		耐压试验压力		0.35 MPa			
	泄漏试验种类		/		泄漏试验压力		/ MPa			
热处理种类		/		热处理温度		/ °C				

安全附件与有关装置

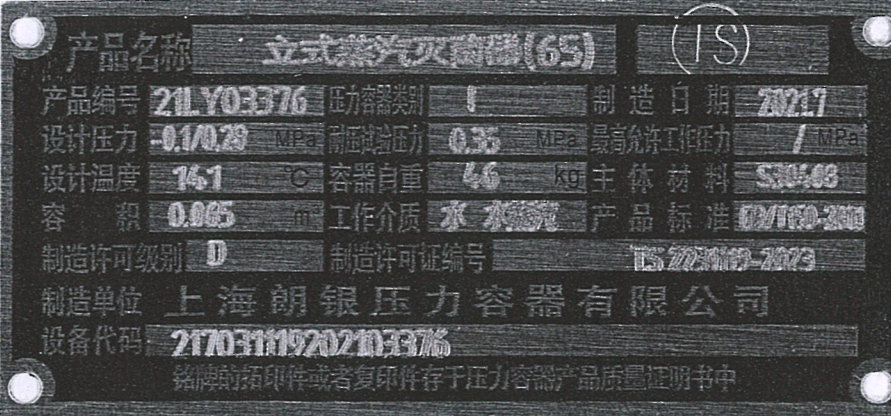 <p>产品名称: 立式蒸汽灭菌器(65) (IS)</p> <p>产品编号: 21LY03376 压力容器类别: I 制造日期: 2021.7</p> <p>设计压力: -0.1/0.28 MPa 耐压试验压力: 0.35 MPa 最高允许工作压力: / MPa</p> <p>设计温度: 141 °C 容器自重: 46 kg 主体材料: S30408</p> <p>容积: 0.065 m³ 工作介质: 水 水蒸汽 产品标准: GB150-2011</p> <p>制造许可级别: D 制造许可证编号: TSG 21001-2021</p> <p>制造单位: 上海朗银压力容器有限公司</p> <p>设备代码: 217031119202103376</p> <p style="font-size: small;">铭牌的照片或者复印件存于压力容器产品质量证明书中</p>	量	制造单位	
			/
			/
			/
			/
			/
设备监督检验所			
检验情况	统一社会信用代码	12310114425053650K	
	机构核准证编号	TS7110221-2022	